

YX

**Method for real-time detection and quantification of agglutinates.**



Patent Number: EP0046430  
Publication date: 1982-02-24  
Inventor(s): ROCHE PIERRE; MARCELLI ALINE  
Applicant(s): COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE (FR); MATERIEL BIOMEDICAL (FR)  
Requested Patent: ☐ EP0046430  
Application Number: EP19810401277 19810807  
Priority Number(s): FR19800017966 19800814  
IPC Classification: G01N21/25 ; G01N33/48  
EC Classification: G01N21/25B2, G01N33/53B  
Equivalents: ☐ FR2488691, ☐ JP57054862

**Abstract**

According to the invention, under conditions comparable to those of the observation corresponding to the detection of possible agglutinates, at least one auxiliary observation of the bottom (11) of the vessel (10) or of a similar vessel is carried out by means of a plurality of photosensitive devices, the vessel (10) thus observed being empty or containing a transparent liquid, and the observation corresponding to the detection of possible agglutinates is corrected as a function of this auxiliary observation, so as to make the

individual responses of the various photosensitive devices uniform.



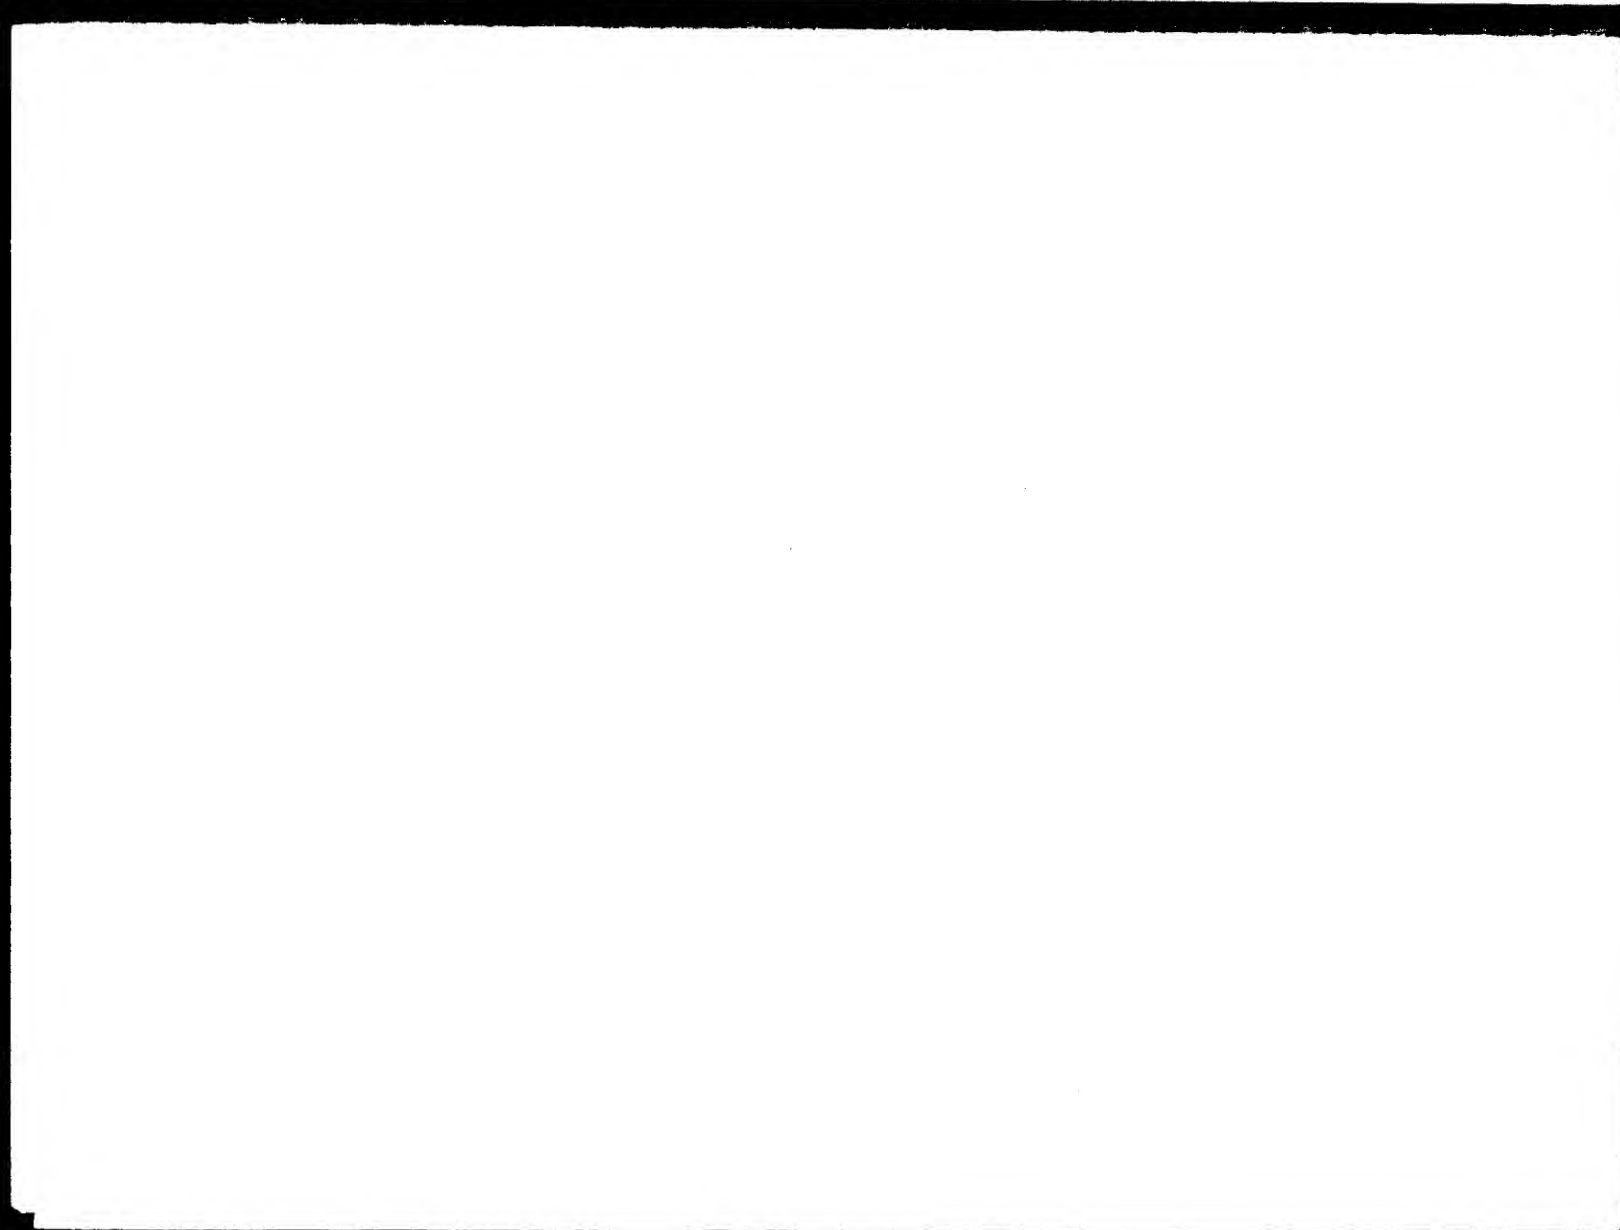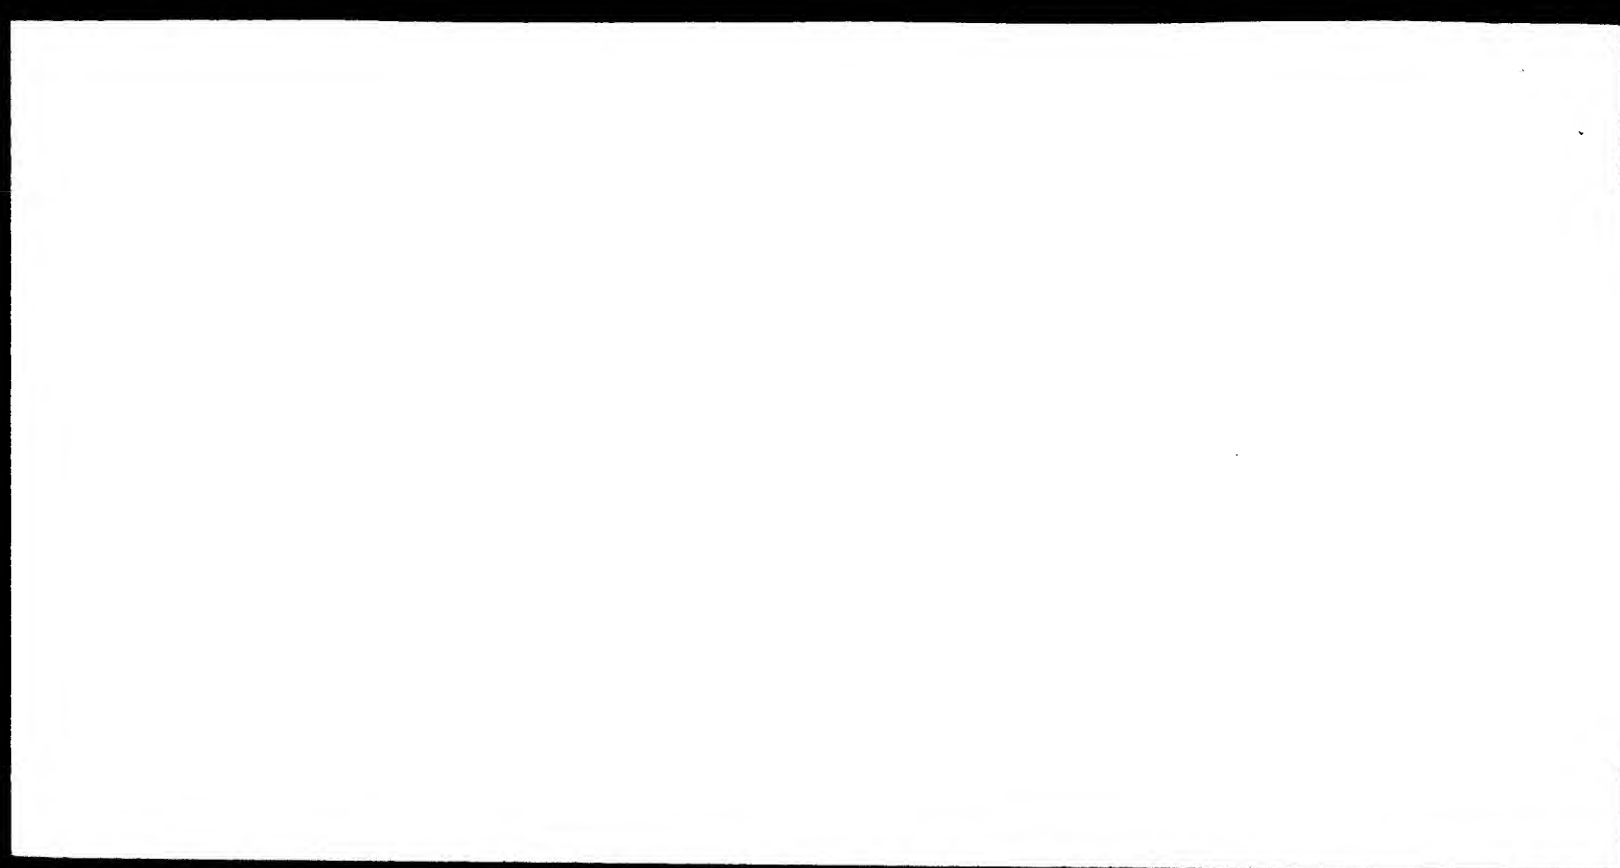

⑫

**DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

⑰ Numéro de dépôt: 81401277.9

⑤① Int. Cl.<sup>3</sup>: **G 01 N 21/25, G 01 N 33/48**

⑳ Date de dépôt: 07.08.81

③① Priorité: 14.08.80 FR 8017966

⑦① Demandeur: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE  
Etablissement de Caractère Scientifique Technique et  
Industriel, 31/33, rue de la Fédération, F-75015 Paris (FR)  
Demandeur: LE MATERIEL BIOMEDICAL Société à  
Responsabilité Limitée dite: 4 rue de Presbourg,  
F-75116 Paris (FR)

④③ Date de publication de la demande: 24.02.82  
Bulletin 82/8

⑦② Inventeur: Roche, Pierre, 155 av. de la République,  
F-94700 Maisons-Alfort (FR)  
Inventeur: Marceill, Alain, 24 avenue Duquesne,  
F-75007 Paris (FR)


⑥④ Etats contractants désignés: BE CH DE FR GB IT LI NL

⑦④ Mandataire: Bonnetat, Christian et al, Cabinet PROPI  
Conseils 23 rue de Léningrad, F-75008 Paris (FR)

⑥⑤ Procédé et dispositif pour la détection et la quantification d'agglutinats en temps réel.

⑥⑦ Procédé et dispositif pour la détection et la quantification d'agglutinats en temps réel.

Selon l'invention, au moyen d'une pluralité de dispositifs photosensibles, on effectue dans des conditions comparables à celles de l'observation correspondant à la détection des éventuels agglutinats, au moins une observation auxiliaire du fond (11) du récipient (10) ou d'un récipient semblable, le récipient (10) ainsi observé étant vide ou contenant un liquide transparent et on corrige l'observation correspondant à la détection des éventuels agglutinats en fonction de cette observation auxiliaire, de façon à rendre homogènes les réponses individuelles des différents dispositifs photosensibles.

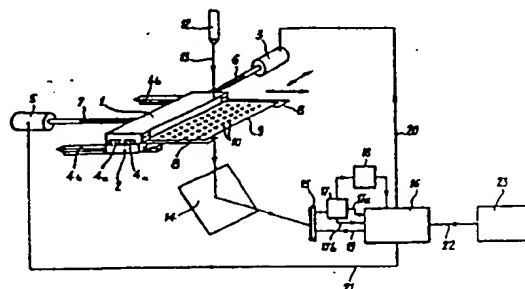

Procédé et dispositif pour la détection et la quantification d'agglutinats en temps réel.

- 1 La présente invention concerne un procédé et un dispositif pour la détection et la quantification, dans un récipient dont au moins le fond est transparent, d'agglutinats susceptibles d'être formés, sous l'action
- 5 d'au moins un réactif, par des particules en suspension dans un liquide se trouvant dans ledit récipient, le fond dudit récipient contenant les éventuels agglutinats étant observé par transparence au moyen d'un agent
- 10 sensibles balayant le fond dudit récipient, de façon à former  $n \times m$  points d'observation répartis selon une surface rectangulaire ou carrée occupant la plus grande partie de la surface dudit fond.
- L'invention peut être utilisée chaque fois que l'on a
- 15 à détecter et à quantifier des agglutinats. Cependant, elle s'applique particulièrement bien en immunohématologie, notamment en vue de la détermination des groupes sanguins. On sait en effet, que la détermination des groupes sanguins est liée à la recherche de l'existence dans le sang d'antigènes érythrocytaires. Les
- 20 réactions immunocytologiques, face à un antigène de groupe spécifique, se traduisent par un phénomène d'agglutination des hématies, si ces dernières appartiennent à un autre groupe. Ces hématies peuvent former
- 25 soit des agglutinats uniformes sans hématies libres, soit quelques gros agglutinats, ou bien encore un grand nombre de petits agglutinats.

On connaît déjà par la demande de brevet français 2 444 939 un dispositif du type décrit ci-dessus.

1 Un tel dispositif est particulièrement avantageux, .  
puisqu'il permet d'utiliser des détecteurs formés par  
un circuit à couplage de charges et donc de profiter  
de l'excellente analyse d'images procurée par un tel  
5 circuit. Cependant, le fonctionnement pratique d'un  
tel dispositif soulève des difficultés. En effet, les  
réponses des différentes diodes à couplage de charges  
individuelles ne sont pas homogènes, ce qui fausse les  
résultats obtenus.

10 La présente invention a pour objet de remédier à cet  
inconvenient et elle permet de lire et de quantifier  
automatiquement, avec précision et en temps réel, les  
agglutinats d'hématies.

A cette fin, selon l'invention, le procédé du type  
15 mentionné ci-dessus est caractérisé en ce que l'on  
effectue, dans des conditions comparables à celles  
de l'observation correspondant à la détection des  
éventuels agglutinats, au moins une observation auxi-  
liaire du fond dudit récipient ou d'un récipient sembla-  
20 ble, le récipient ainsi observé étant vide ou contenant  
un liquide transparent et on corrige l'observation  
correspondant à la détection des éventuels agglutinats  
en fonction de cette observation auxiliaire, de façon  
à rendre homogènes les réponses individuelles des diffé-  
25 rents dispositifs photosensibles.

On remarquera que le brevet britannique 2 014 300  
décrit déjà une telle observation auxiliaire. Cependant,  
dans ce cas, le dispositif d'observation ne comporte  
qu'un seul détecteur individuel par cellule, de sorte  
30 que l'observation auxiliaire n'est pas destinée à  
homogénéiser les réponses d'une multiplicité de dispo-  
sitifs photosensibles d'observation, mais uniquement

- 1 à prendre en compte dans la mesure, le fond dudit réci-  
pient.

De préférence, dans la mise en oeuvre du procédé confor-  
me à l'invention, on observe, dans des conditions com-  
5 parables à celles de l'observation correspondant à la  
détection des éventuels agglutinats et dans le même  
récipient ou dans un récipient semblable, un échantil-  
lon témoin du liquide dans lequel lesdites particules  
ne sont pas agglutinées, on corrige cette observation  
10 de l'échantillon témoin en fonction de l'observation

indications obtenues dans les deux observations corri-  
gées pour déterminer, dans la première citée, l'exis-  
tence et l'importance d'une éventuelle agglutination.

- 15 Dans un mode avantageux de réalisation, l'agencement  
de dispositifs photosensibles est formé de  $n$   
dispositifs photosensibles alignés et le balayage  
du fond du récipient, lors de l'observation des  
éventuels agglutinats, est obtenue par  $m$  déplacements  
20 relatifs dudit agencement par rapport au fond, tandis  
que l'observation auxiliaire et l'observation de  
l'échantillon témoin sont effectuées dans une seule  
position relative de l'agencement par rapport au fond  
du récipient, correspondant au moins approximativement  
25 au centrage dudit agencement par rapport à ce dernier.  
Bien entendu, cette mesure avantageuse n'est pas limi-  
tative et l'observation auxiliaire et l'observation de  
l'échantillon témoin pourraient être effectuées dans  
des conditions de balayage identiques à celles de  
30 l'observation des éventuels agglutinats.

Les dispositifs photosensibles sont avantageusement  
du type à couplage ou à transfert de charge, ces

- 1 dispositifs étant généralement désignés par les lettres  
CCD, DTC ou CCPD.

Dans le balayage du fond du récipient, lors de l'observation des éventuels agglutinats, on peut bien entendu  
5 choisir  $n = m$  et faire en sorte que l'écart entre deux positions d'observation consécutives de la barrette soit égal à l'écart entre deux dispositifs CCD de la barrette. Ainsi, on couvre totalement une surface carrée du fond transparent. Par exemple, la barrette rectiligne  
10 comporte 256 diodes CCD, ayant chacune une définition de 25  $\mu\text{m}$ , l'information vidéo étant numérisée en 256 niveaux de gris, et l'image analysée représente un carré centré sur ledit fond transparent et formé par 256 balayages écartés de 25  $\mu\text{m}$ .

- 15 On obtient ainsi, pour l'observation des agglutinats,  $n \times m$  mesures, réparties en  $m$  balayages de  $n$  points.

Il est avantageux, lors de l'observation de l'échantillon témoin et après correction par l'observation auxiliaire, d'effectuer la moyenne des réponses des dispositifs  
20 photosensibles de l'agencement et d'utiliser cette moyenne pour établir au moins un seuil moyen de référence.

De préférence, à partir de cette moyenne, on établit un seuil minimum et un seuil maximum, respectivement inférieur et supérieur à cette moyenne de quantités choisies  
25 volontairement en fonction de l'analyse effectuée et des connaissances que l'on en a, puis, lors de l'observation des éventuels agglutinats, on compare les réponses des dispositifs photosensibles de l'agencement pour  
30 chacun des  $n \times m$  points d'observation audit seuil minimum et maximum et l'on répartit lesdites réponses

- 1 en trois classes différentes, selon qu'elles sont supérieures au seuil maximum, inférieures au seuil minimum ou comprises entre ces deux seuils.

Un dispositif selon l'invention, pour mettre en oeuvre  
5 le procédé décrit ci-dessus, comporte avantageusement, à poste fixe, d'une part une source de lumière et d'autre part un système optique et un agencement de dispositifs photosensibles associés à des moyens de mémorisation des signaux qui en sont issus, des moyens  
10 mobiles de support pour faire défiler ledit récipient

des moyens de commande desdits dispositifs photosensibles, des moyens moteurs pour mouvoir lesdits moyens mobiles de support, des moyens de commande desdits  
15 moyens moteurs, des moyens de synchronisation entre lesdits moyens de commande des dispositifs photosensibles et lesdits moyens de commande des moyens moteurs et des moyens de traitement des signaux provenant desdits moyens de mémorisation.

20 Les moyens de commande des dispositifs photosensibles, les moyens de commande des moyens moteurs, lesdits moyens de synchronisation et lesdits moyens de traitement peuvent être rassemblés dans un microprocesseur.

25 Dans le cas d'une pluralité d'alvéoles solidaires d'une plaque transparente, lesdits moyens moteurs sont constitués de deux moteurs pas à pas croisés, tandis que lesdits moyens mobiles de support sont constitués de deux tables mobiles croisées, dont chacune d'elles est  
30 mue par l'un desdits moteurs.



- 1 Les figures du dessin annexé feront bien comprendre comment l'invention peut être réalisée.

La figure 1 est une vue schématique en perspective du dispositif selon l'invention.

- 5 La figure 2 est une vue en plan d'une plaquette à alvéoles utilisée en combinaison avec le dispositif de la figure 1.

La figure 3 est une coupe suivant la ligne III-III de la figure 2.

- 10 Les figures 4, 5 et 6 illustrent schématiquement une partie du fonctionnement du dispositif selon l'invention.

Les figures 7 et 8 sont des courbes de résultat de tests effectués au moyen du dispositif selon l'invention.

- 15 Le dispositif selon l'invention montré par la figure 1, comporte deux tables 1 et 2 à coulisement croisé. La table 1 peut glisser, sous l'action d'un moteur pas-à-pas 3, le long des rails 4a solidaires de la table 2. De façon semblable, la table 2 peut glisser sous l'action  
20 d'un moteur 5, le long de rails 4b solidaires du bâti non représenté du dispositif. Les rails 4a et 4b sont orthogonaux. La liaison entre le moteur 3 et la table 1 d'une part, et entre le moteur 5 et la table 2 d'autre  
25 gées dans des écrous (non-visibles sur la figure) respectivement solidaires desdites tables 1 et 2.

Des bras saillants 8, solidaires de la table 1, sont prévus pour supporter, en porte-à-faux, une plaquette

1 transparente 9, pourvue d'une pluralité d'alvéoles 10.  
Comme le montre les figures 2 et 3, les alvéoles 10 sont  
répartis en sept colonnes, référencées de A à G, de  
douze alvéoles chacune. De façon connue la plaque 9  
5 est moulée dans une matière transparente, chacun des-  
dits alvéoles étant ouvert vers le haut et ayant une  
forme conique ou cylindrique, avec un fond 11 plat.  
Au point de vue optique chaque fond 11 forme une lame  
plane à faces parallèles.

10 Au-dessus de la plaque 9 est prévue une source lumi-  
~~neuse 12 constante pendant la durée de l'analyse, par~~  
exemple à faisceau de fibres optiques, émettant un  
faisceau lumineux 13. Au dessous de la plaque 9 est  
disposé un miroir réfléchissant 14 dirigeant le faisceau  
15 13, après une traversée de la plaque 9, sur une barrette  
15 comportant une pluralité de dispositifs à couplage  
de charges alignées.

Une unité de commande, de traitement et de calcul 16  
reçoit, par un aiguilleur 17 et une mémoire 18, les  
20 informations recueillies par la barrette 15 et, par des  
liaisons 19, 20, 21 et 22, commande respectivement  
ladite barrette 15, le moteur 5 et un dispositif d'affi-  
chage 23.

On conçoit aisément que par coulisement croisé des  
25 tables 1 et 2 dans des directions et sens indiqués par  
les flèches de la figure 1 et parallèles aux rails 4a  
et 4b, il est possible d'amener successivement chacun  
des alvéoles 10 de la plaque 9 dans le faisceau 13,  
c'est-à-dire dans le champ de la barrette 15. Par exem-  
30 ple, c'est d'abord l'alvéole 1 de la colonne A qui se  
trouve en regard de la source 12, puis l'alvéole 2 de  
la colonne A, etc... jusqu'à l'alvéole 12 de la

1 colonne A, après quoi l'alvéole 1 de la colonne B est  
amené dans le faisceau 13, puis l'alvéole 2 de la colon-  
ne B, etc... jusqu'à l'alvéole 12 de la colonne G.

5 Les douze alvéoles de chacune des colonnes A à G peuvent  
être destinés aux tests concernant chacun une personne,  
de sorte que des tests concernant sept personnes  
peuvent être effectués à l'aide d'une seule plaquette 9.

10 Par exemple, dans chacune des colonnes d'alvéoles A à G,  
le premier alvéole est vide (ou rempli de sérum physiolo-  
gique) et le second alvéole contient un tapis d'hématies  
libres, alors que les dix autres alvéoles suivants  
contiennent du sang additionné de divers réactifs  
susceptibles d'entraîner des agglutinations d'hématies.

15 A partir d'une position initiale définie grâce à des  
capteurs de positions (non représentés), la plaquette 10  
est d'abord amenée dans une position pour laquelle le  
fond du premier alvéole d'une colonne (vide ou rempli  
de sérum physiologique) est projetée sur la barrette 15,  
celle-ci étant centrée par rapport audit fond. On effec-  
20 tue alors une mesure, de sorte que l'on obtient pour  
un écartement constant, un signal S irrégulier (voir  
la figure 4). L'irrégularité du signal S est due à  
l'inhomogénéité des diodes CCD de la barrette 15 et  
aux déformations optiques du fond 11. Sur la figure 4,  
25 le signal S est représenté par un niveau de tension V  
en fonction du temps  $t$ , c'est-à-dire en réalité de la  
succession des 256 diodes de la barrette 15. Le signal S  
est transmis, par l'aiguilleur 17, à la mémoire 18,  
de type FIFO (first in, first out), à laquelle est  
30 associé un inverseur (non-représenté), de sorte qu'à  
la sortie de ladite mémoire apparaît le signal  $\bar{S}$  de  
la figure 5.

- 1 Ensuite, sous l'action des moteurs 3 et 5 et sous la  
commande de l'unité 16, la plaquette 9 est déplacée  
de façon que le fond du second alvéole de la même  
colonne (contenant un tapis d'hématies libres) soit  
5 projeté sur la barrette 15, en position centrée. Une  
mesure à cet instant fournit un signal témoin consti-  
tué par les réponses des 256 diodes. Ce signal témoin  
est transmis, par l'aiguilleur 17 et la liaison 17a, à  
l'unité centrale 16 où il est additionné au signal  $\bar{S}$ .  
10 Il est donc corrigé des déformations optiques et des  
~~inhomogénéités de réponse des diodes. Les 256 réponses~~  
~~ainsi corrigées des diodes sont additionnées et moyennées~~  
sées par 256 par ladite unité 16 de sorte que l'on  
obtient une moyenne  $M$  servant de seuil moyen de  
15 référence. A partir de cette moyenne  $M$ , on détermine  
un seuil minimum  $S_{\min} = M - \epsilon$  et un seuil  
maximum  $S_{\max} = M + \epsilon$ ,  $\epsilon$  étant choisi volontairement  
en fonction de l'analyse effectuée et des connaissances  
que l'on en a.
- 20 Ensuite, on effectue la mesure de chacun des alvéoles  
suivants de la même colonne. Lorsqu'un de ces dix  
alvéoles susceptible de contenir des agglutinats  
est amené dans le champ de la barrette 15, on effectue  
une pluralité de mesures, selon le processus illustré  
25 par la figure 6. Sur cette figure, on a supposé que  
l'image du fond 11 d'un alvéole 10 est superposé à  
la barrette 15, que ledit fond défilait de la droite  
vers la gauche, selon la flèche  $F$  et que la barrette 15  
comprenait  $n$  diodes CCD, équidistantes de la distance  $d$ .  
30 L'unité 16 commande les moteurs 3 et 5 pour que la  
barrette 15 prenne une position  $15_1$  initiale extrême et  
une mesure est effectuée de sorte que les  $n$  diodes CCD  
fournissent leur éclaircissement reçu dans cette position.

- 1 La mesure est transmise, par l'aiguilleur 17 et la liaison 17b, à l'unité 16 qui la linéarise grâce au signal  $\bar{S}$  provenant de la mémoire 18. On obtient alors une valeur  $N_1$  par diode
- 5 Si  $N_1 > S_{\max}$ , on peut en déduire qu'il y a agglutination.
- Si  $N_1 < S_{\min}$ ,  $N_1$  correspond au fond de l'image. et,
- Si  $S_{\min} < N_1 < S_{\max}$ , il n'y a pas agglutination.
- L'unité 16 comporte trois compteurs (non-représentés), dont chacun correspond à l'une des trois classes précédentes et vers lesquelles sont dirigées les valeurs
- 10  $N_1$  obtenues qui sont stockées dans le compteur approprié.
- Ensuite, la barrette 15 est amenée dans la position 15<sub>2</sub> voisine, parallèle et distante de  $\underline{d}$ , où une mesure est de nouveau effectuée. On obtient de nouvelles valeurs  $N_2$ ,
- 15 qui sont également comparées à  $S_{\max}$  et  $S_{\min}$  et stockées dans le compteur correspondant. On continue ainsi, jusqu'à ce que l'on arrive dans la position finale extrême 15<sub>n</sub>, où les dernières valeurs  $N_n$  sont classées et emmagasinées.
- 20 Des contenus des trois compteurs, l'unité 16 déduit s'il y a agglutination ou non et détermine le type de l'éventuelle agglutination. Le résultat est affiché en 23.
- Ensuite, l'unité 16 commande les moteurs 3 et 5 pour
- 25 amener l'alvéole suivant dans le champ de la barrette 15, etc...

- 1 La figure 6 montre que chaque alvéole susceptible de contenir des agglutinats subit une observation en  $n^2$  points formant un carré inscrit dans le fond 11.

- 5 Les figures 7 et 8 illustrent le résultat de tests réalisés, sur une suspension d'hématies de groupe A au moyen d'un sérum contenant un anti-corps anti-A. La figure 7 représente, en fonction de la dilution  $c$  du sérum (de  $\frac{1}{2}$  à  $\frac{1}{128}$ ) dans de l'eau physiologique, le nombre ND de diodes CCD du dispositif 15, occultées

figure 6, respectivement par les agglutinats (courbe AG), les érythrocytes libres (courbe EL) et le fond de l'image (courbe FI).

- 15 Sur la figure 8, on a porté (en %) le rapport
- $$\rho = \frac{\text{Nombre de diodes CCD occultées par les agglutinats}}{\text{Nombre de diodes CCD occultées par les agglutinats} + \text{Nombre de diodes CCD correspondant aux érythrocytes libres}}$$
- en fonction de la dilution  $c$ .

- 20 Ces courbes montrent que, pour une suspension d'hématies donnée, le rapport  $\rho$  varie de façon quantifiée en fonction de la dilution et que, en conséquence, le procédé et le dispositif selon l'invention permettent la quantification des agglutinats. De plus, comme il a été expliqué ci-dessus, cette quantification s'effectue en temps
- 25 réel.

## REVENDICATIONS

- 1 1 - Procédé pour la détection et la quantification, dans  
un récipient dont au moins le fond est transparent,  
d'agglutinats susceptibles d'être formés, sous l'action  
d'au moins un réactif, par des particules en suspension  
5 dans un liquide se trouvant dans ledit récipient, selon  
lequel on observe par transparence le fond (11) dudit  
récipient (10) contenant les éventuels agglutinats au  
moyen d'un agencement (15) comportant une pluralité  
de dispositifs photosensibles balayant le fond (11) du ré-  
10 cipient (10), de façon à former  $n \times m$  points d'observa-  
tion répartis selon une surface rectangulaire ou carrée  
occupant la plus grande partie de la surface dudit  
fond (11),  
caractérisé en ce que l'on effectue dans des conditions  
15 comparables à celles de l'observation correspondant  
à la détection des éventuels agglutinats, au moins une  
observation auxiliaire du fond (11) dudit récipient (10)  
ou d'un récipient semblable, le récipient (10) ainsi  
observé étant vide ou contenant un liquide transparent  
20 et on corrige l'observation correspondant à la détec-  
tion des éventuels agglutinats en fonction de cette  
observation auxiliaire, de façon à rendre homogènes  
les réponses individuelles des différents dispositifs  
photosensibles.
- 25 2 - Procédé selon la revendication 1,  
caractérisé en ce que l'on observe, dans des conditions  
comparables à celles de l'observation correspondant  
à la détection des éventuels agglutinats et dans le  
même récipient (10) ou dans un récipient semblable, un  
30 échantillon témoin dudit liquide dans lequel lesdites  
particules ne sont pas agglutinées, en ce que l'on corri-  
ge cette observation de l'échantillon témoin en fonction

de l'observation auxiliaire, et en ce que l'on compare les indications obtenues dans les deux observations corrigées pour déterminer, dans la première citée, l'existence et l'importance d'une éventuelle agglutination.

3.- Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'agencement (15) est formé

10 le balayage du fond (11) du récipient (10) lors de l'observation des éventuels agglutinats, est obtenu par m déplacements relatifs dudit agencement (15) par rapport audit fond (11).

15 4.- Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les dispositifs photosensibles sont du type à couplage ou à transfert de charges.

20 5.- Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, lors de l'observation de l'échantillon témoin et après correction par l'observation auxiliaire, on effectue la moyenne des réponses des dispositifs photosensibles de l'agencement (15) et on utilise cette moyenne pour établir au moins un

25 seuil moyen de référence.






- 1 6 - Procédé selon la revendication 5,  
caractérisé en ce que, à partir de ladite moyenne, on  
établit un seuil minimum et un seuil maximum respecti-  
5 vement inférieur et supérieur à cette moyenne de quan-  
tités choisies volontairement en fonction de l'analyse  
effectuée et des connaissances que l'on en a, en ce  
que, lors de l'observation des éventuels agglutinats,  
on compare la réponse des dispositifs photosensibles  
de l'agencement (15) pour chacun des  $n \times m$  points  
10 d'observation auxdits seuils minimum et maximum et en  
ce que l'on répartit lesdites réponses en trois clas-  
ses différentes, selon qu'elles sont supérieures au  
seuil maximum, inférieures au seuil minimum ou comprises  
entre ces deux seuils.
- 15 7 - Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé  
spécifié dans l'une quelconque des revendications  
précédentes,  
caractérisé en ce qu'il comporte, à poste fixe, d'une  
part une source de lumière (12) et d'autre part un  
20 système optique (14) et un agencement (15) de disposi-  
tifs photosensibles associés à des moyens de mémorisa-  
tion des signaux qui en sont issus, des moyens mobiles  
de support (1,2) pour faire défiler ledit récipient  
entre ladite source de lumière et ledit système optique,  
25 des moyens de commande (19) desdits dispositifs photo-  
sensibles, des moyens moteurs (3,5) pour mouvoir lesdits  
moyens mobiles de support (1,2), des moyens de commande  
(16) desdits moyens moteurs, des moyens de synchronisa-  
tion (16) entre lesdits moyens de commande (16) des  
30 dispositifs photosensibles (15) et lesdits moyens de  
commande (16) des moyens moteurs (3,5) et des moyens  
de traitement (16) des signaux provenant desdits moyens  
de mémorisation.

- 1 8 - Dispositif selon la revendication 7,  
caractérisé en ce que les moyens de commande des  
dispositifs photosensibles, les moyens de commande des  
moyens moteurs, lesdits moyens de synchronisation  
5 et lesdits moyens de traitement sont rassemblés dans  
un microprocesseur (16).




- 9 - Application du procédé spécifié selon l'une  
des revendications 1 à 6 ou du dispositif selon l'une  
des revendications 7 ou 8 à la reconnaissance de  
10 caractères immunocytologiques.

Fig. 1

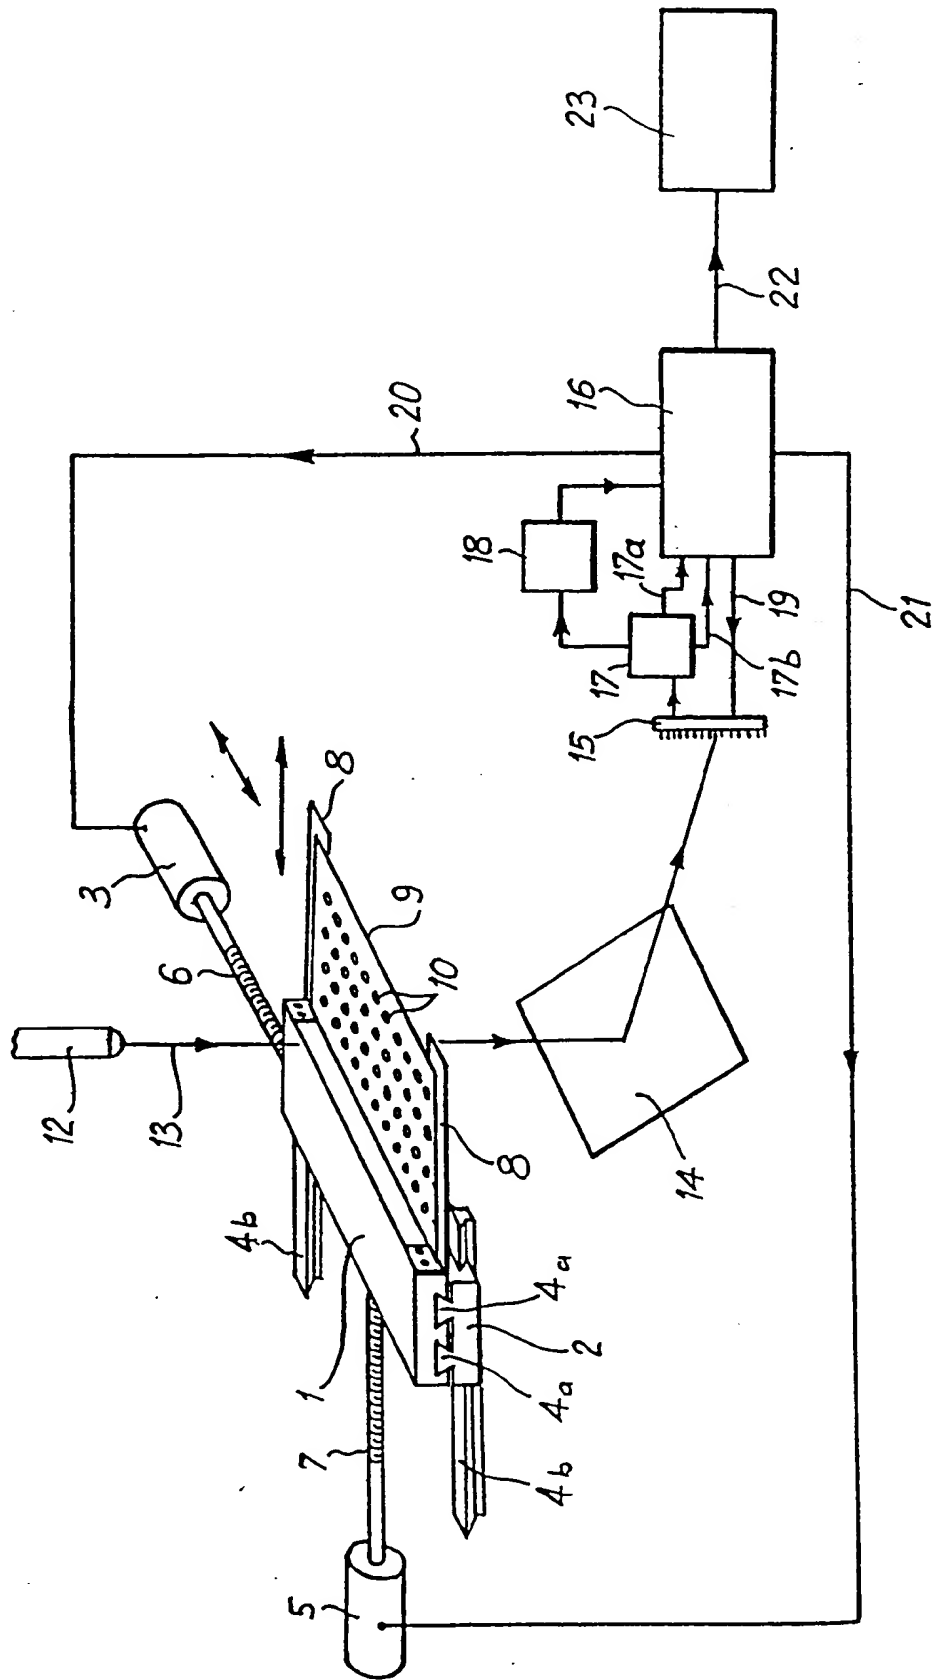

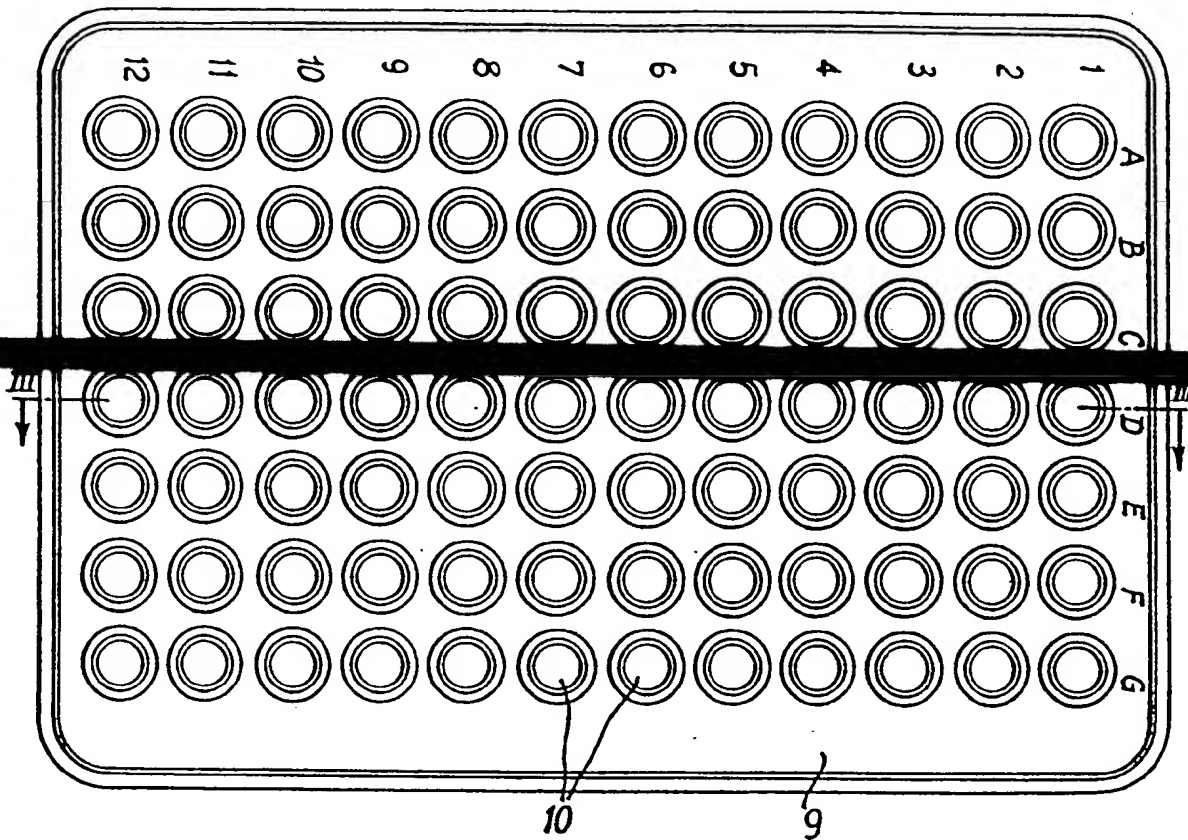
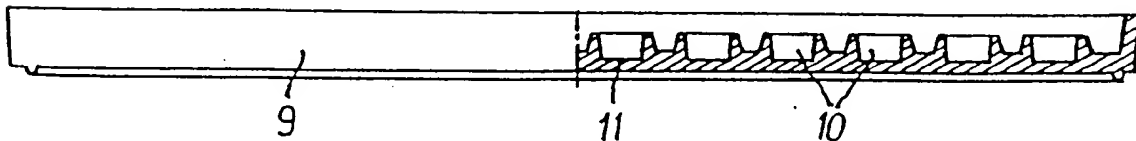
*Fig. 2**Fig. 3*

3/4

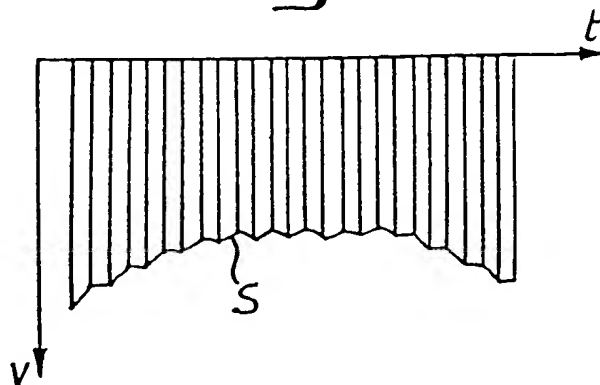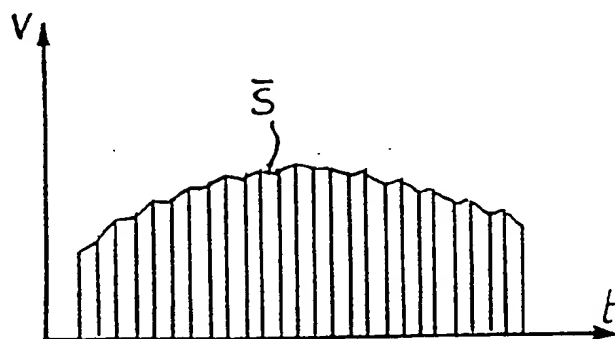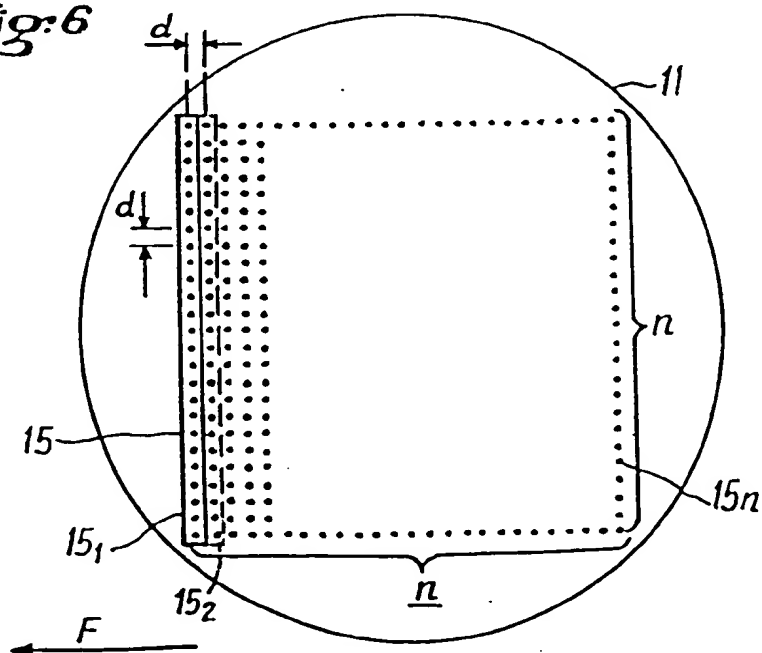*Fig:4**Fig:5**Fig:6*

4/4

0046430

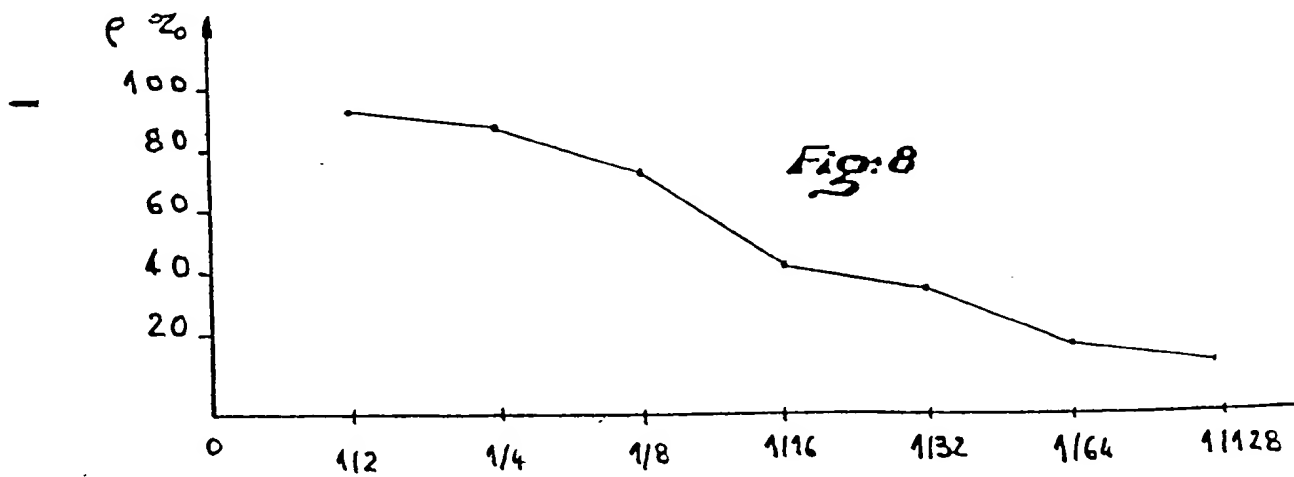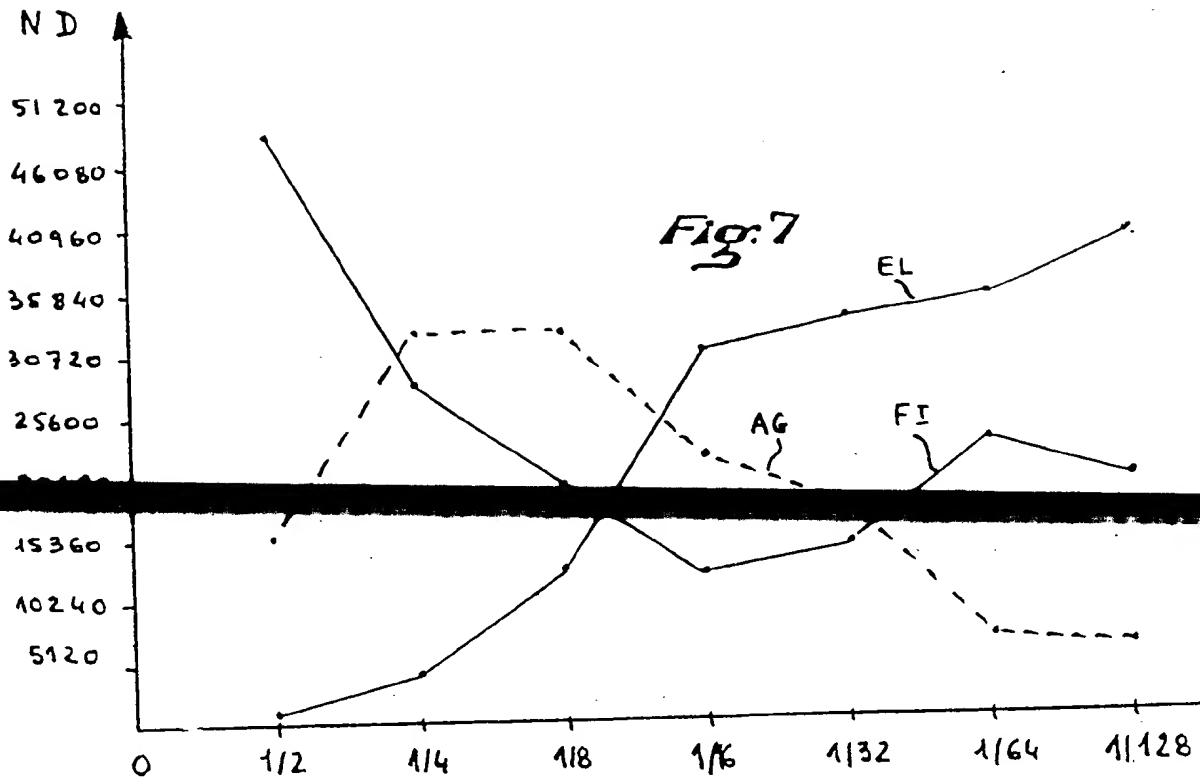



Office européen  
des brevets

# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0046430  
N° de la demande  
EP 81 401 277

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.)
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	
D	<u>FR - A - 2 444 939</u> (AKRO-MEDIC ENGINEERING)  * pages 14-16; figures 8-11 *  --	1,4,7,9	G 01 N 21/25 G 01 N 33/48
D	<u>GB - A - 2 014 300</u> . (OPTO ELECTRONIC DISPLAYS)  * page 1 *  --	1,2	
A	<u>EP - A - 0 012 698</u> (MERCK & CO.)  * pages 2,3 *  --	1	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.)  G 01 N 21/25 G 01 N 33/48
A	CLINICAL CHEMISTRY, vol. 25, no. 4, avril 1979 EASTON, PENN. (US) C.H. McMURRAY et al.: "Multi-Channel, Probe Colorimeter for Use with the Micro-ELISA Test, Which Makes Use of Disposable Flat-Bottom Microhemagglutination Plates", pages 570-576.  * pages 570-572 *  --	1,2	CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES  X: particulièrement pertinent A: arrière-plan technologique O: divulgation non-écrite P: document intercalaire T: théorie ou principe à la base de l'invention E: demande faisant interférence D: document cité dans la demande L: document cité pour d'autres raisons
A	<u>US - A - 3 773 426</u> (C. MUDD)  * colonne 3; colonne 4; figures 1,4 *  -----	1	&: membre de la même famille. document correspondant
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche La Haye		Date d'achèvement de la recherche 23.11.1981	Examineur BOEHM

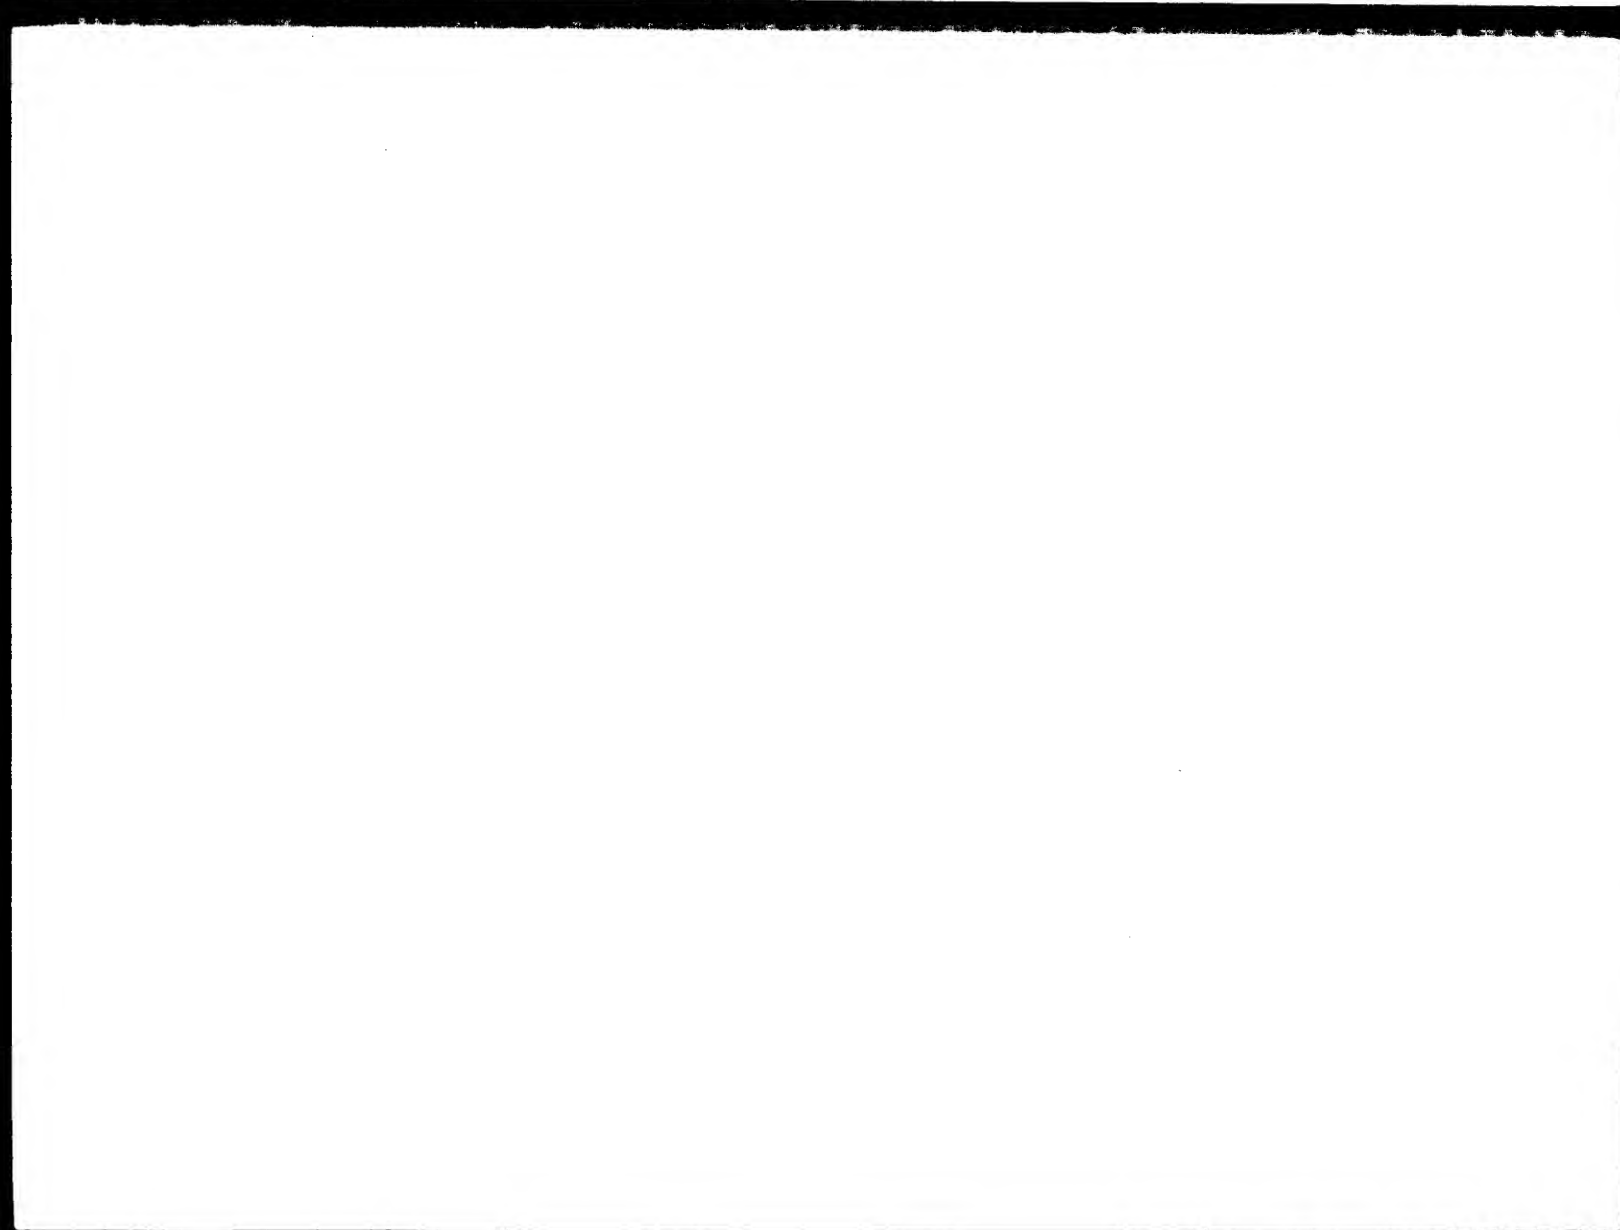
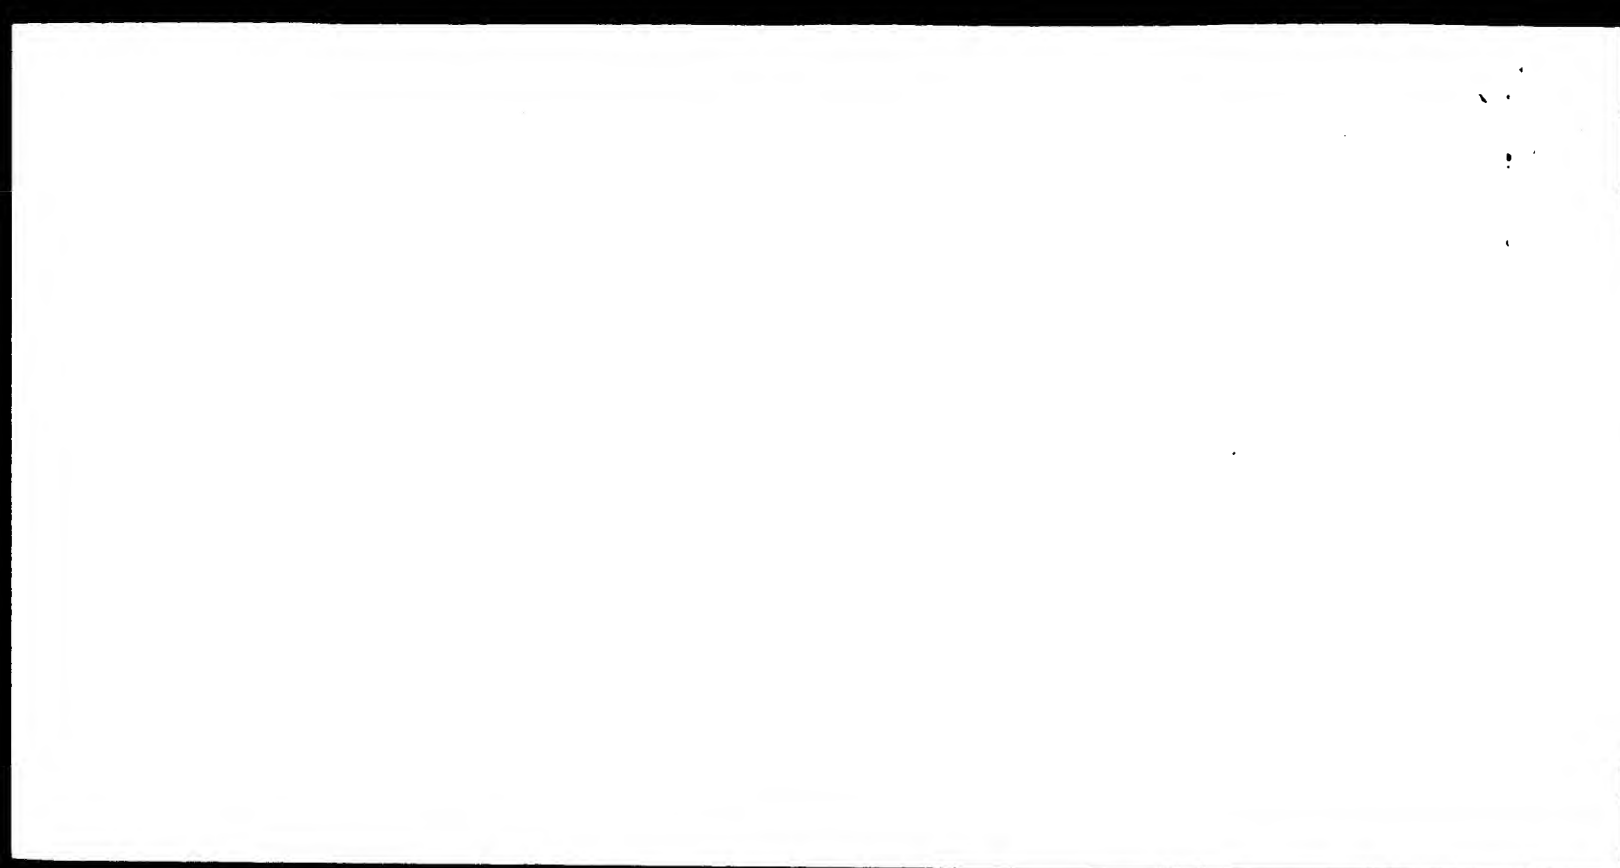
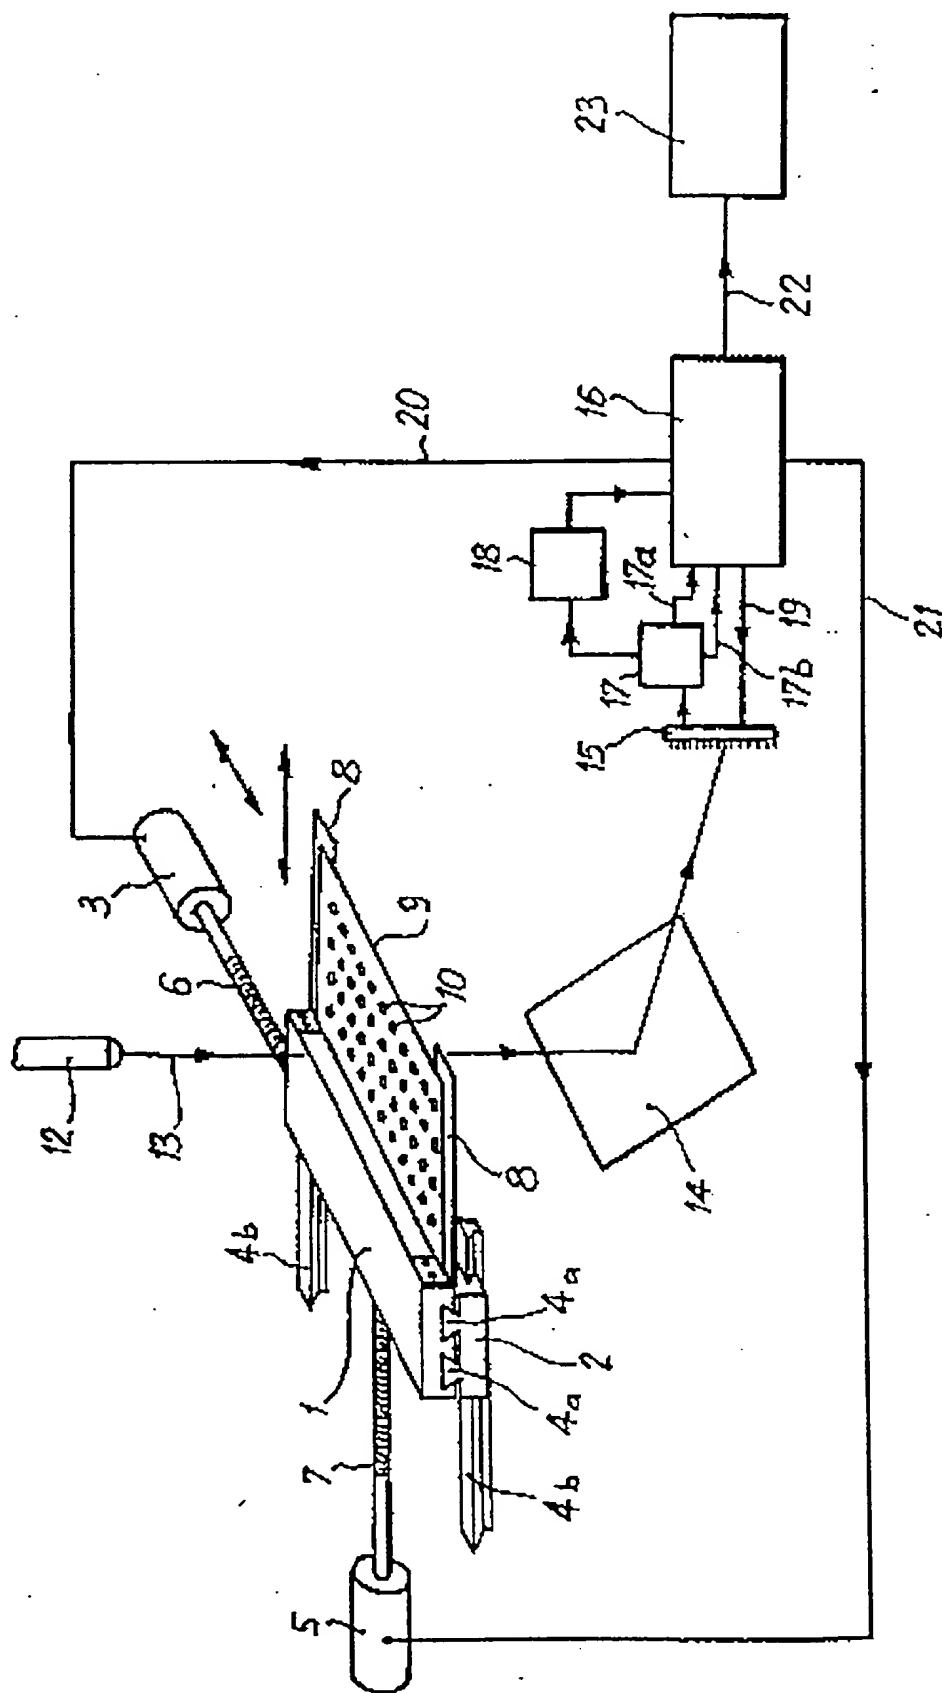
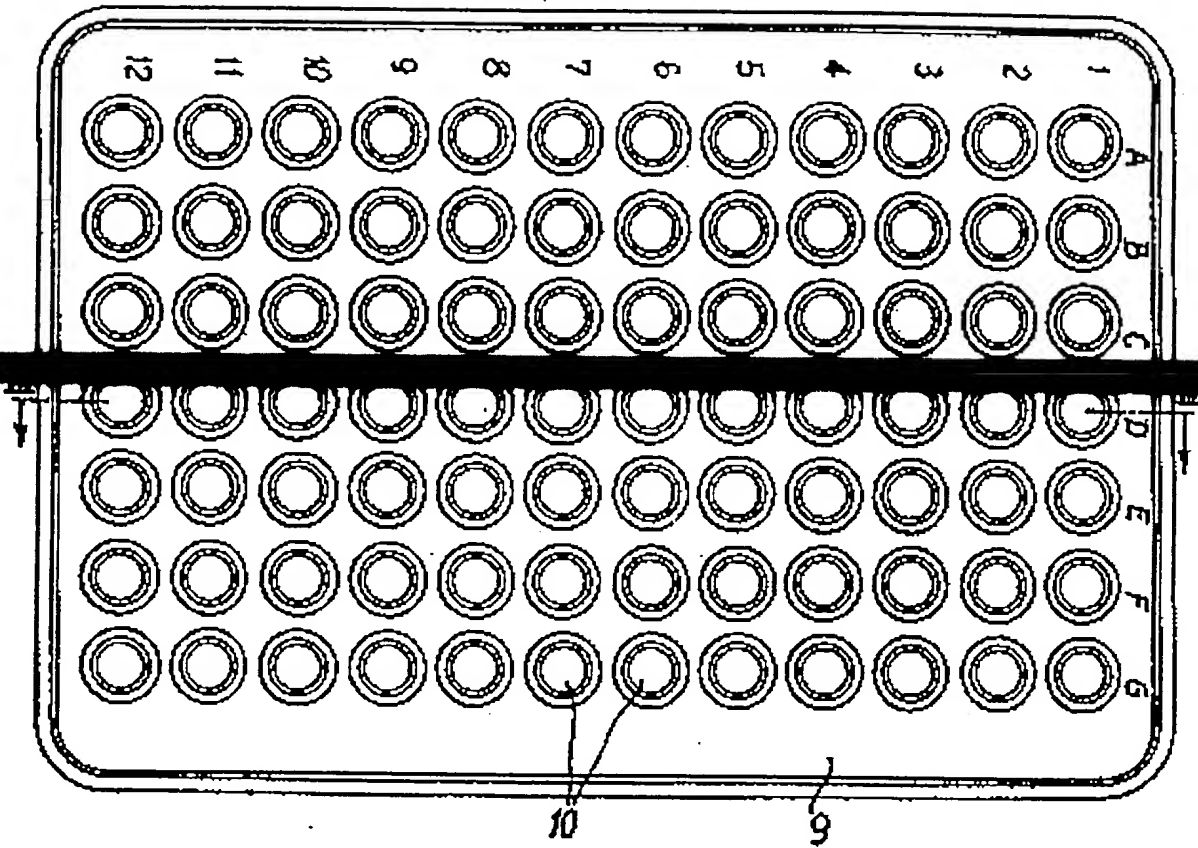
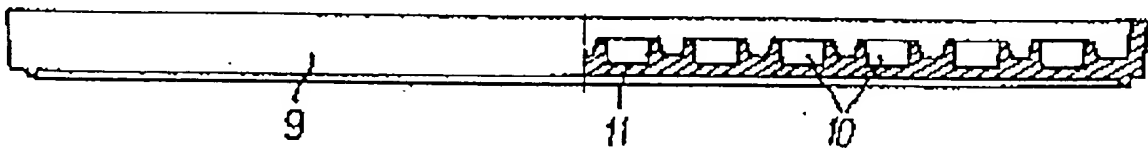
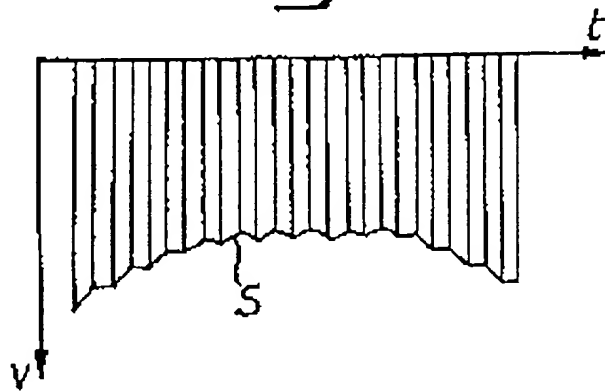
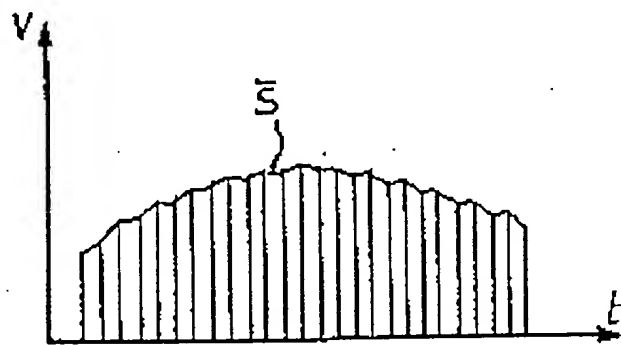
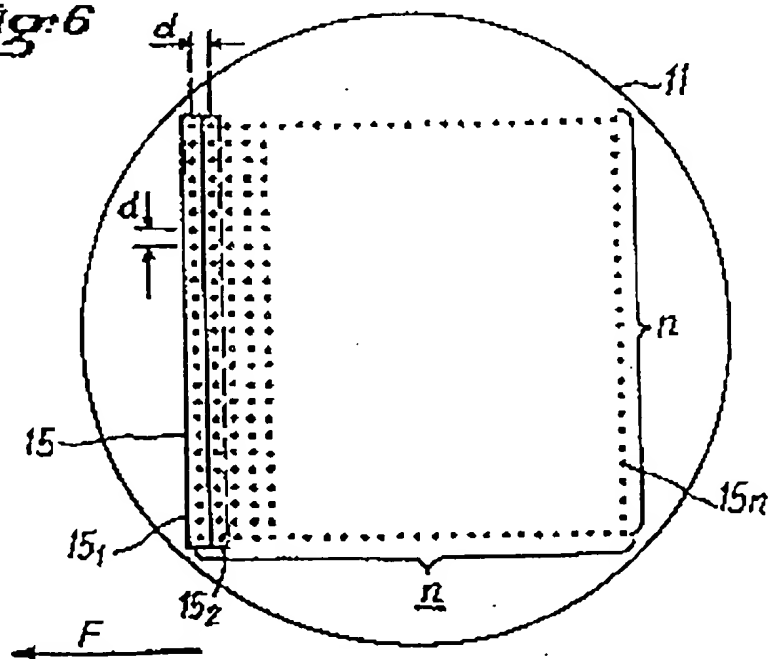




Fig. 1



*Fig. 2**Fig. 3*

*Fig. 4**Fig. 5**Fig. 6*

4/4

0046430

